Veškerá produktová dokumentace ve službě eLabDoc

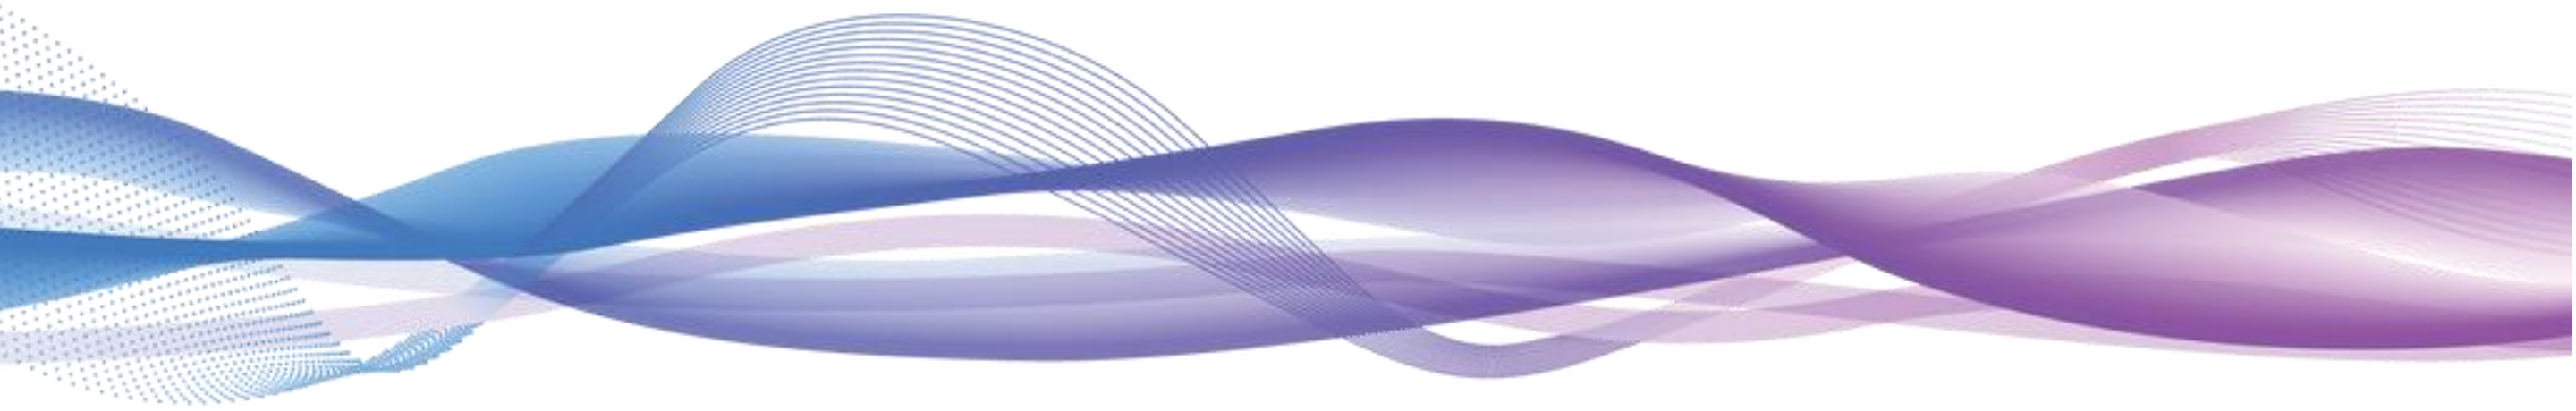

eLabDoc

Služba eLabDoc vám umožní vyhledat potřebné **technické dokumenty** k produktům Roche Diagnostics. Veřejná část služby obsahuje pouze vybrané typy dokumentů, pro přístup ke všem typům dokumentů je nutná registrace na zákaznický Portál **navify**®.

Dokumenty dostupné bez přihlášení:

- Metodické listy
- CE certifikáty
- Certifikáty o analýze
- Bezpečnostní listy

Po přihlášení můžete navíc stahovat:

- Kontroly kvality – hodnoty
- Listy s čárovými kódy
- Návaznosti a nejistoty
- Uživatelské příručky

Vyhledávání

Vyhledávat můžete buď jednotlivé **dokumenty**, nebo **produkty**. U obou typů vyhledávání můžete **výsledky filtrovat** podle řady parametrů. Do vyhledávání zadejte katalogové číslo produktu nebo jeho název (nebo část názvu).

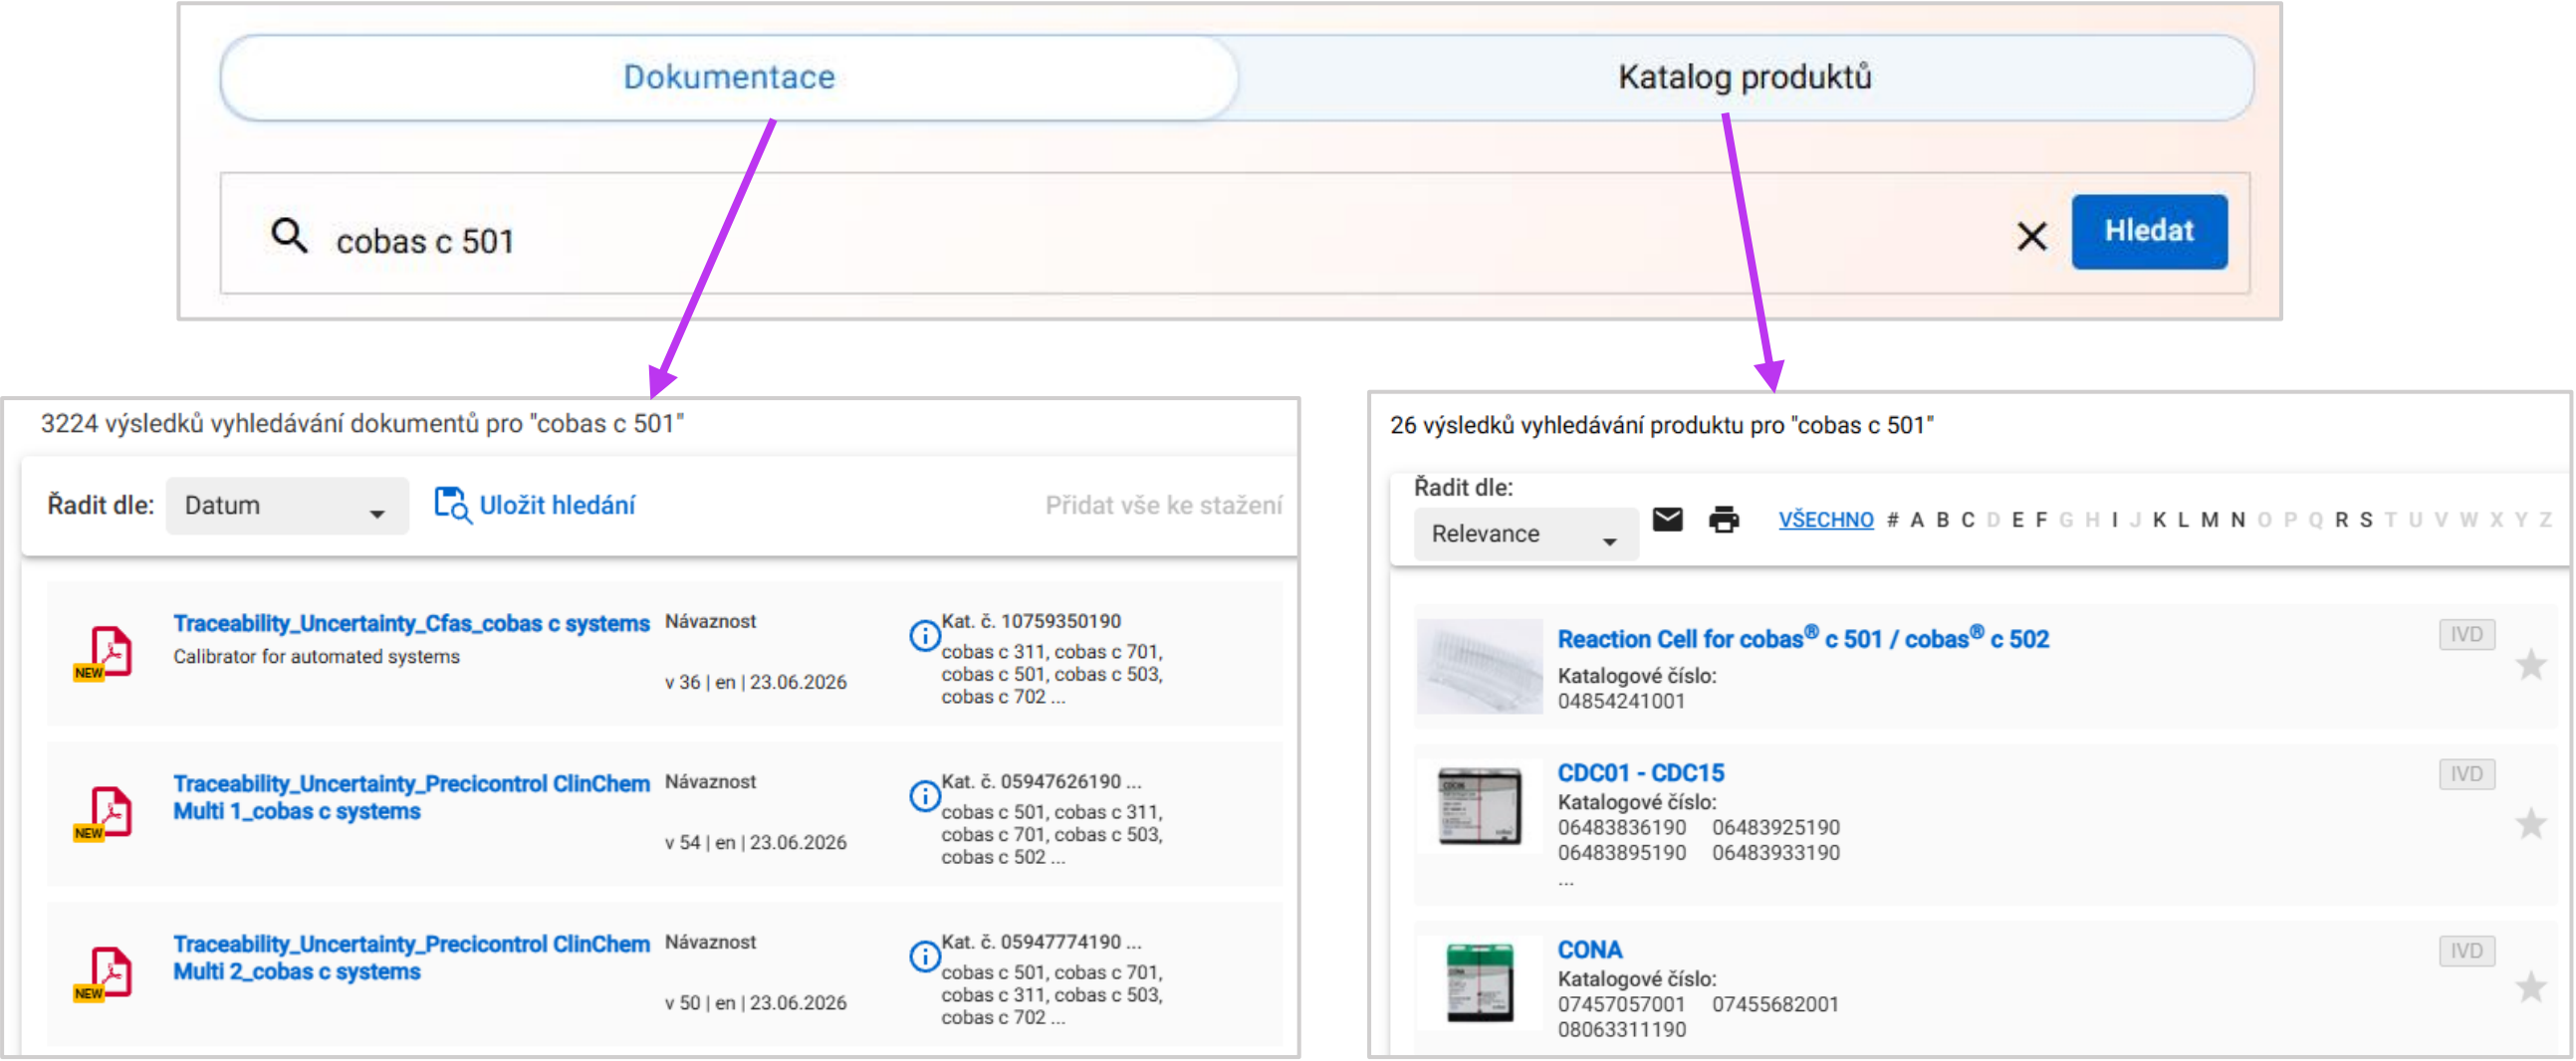

3224 výsledků vyhledávání dokumentů pro "cobas c 501"

Traceability_Uncertainty_Cfas_cobas c systems
Calibrator for automated systems
Návaznost
v 36 | en | 23.06.2026
Kat. č. 10759350190
cobas c 311, cobas c 701, cobas c 501, cobas c 503, cobas c 702 ...

Traceability_Uncertainty_Precicontrol ClinChem Multi 1_cobas c systems
Návaznost
v 54 | en | 23.06.2026
Kat. č. 05947626190 ...
cobas c 501, cobas c 311, cobas c 701, cobas c 503, cobas c 502 ...

Traceability_Uncertainty_Precicontrol ClinChem Multi 2_cobas c systems
Návaznost
v 50 | en | 23.06.2026
Kat. č. 05947774190 ...
cobas c 501, cobas c 701, cobas c 311, cobas c 503, cobas c 702 ...

26 výsledků vyhledávání produktu pro "cobas c 501"

Reaction Cell for cobas® c 501 / cobas® c 502
Katalogové číslo:
04854241001

CDC01 - CDC15
Katalogové číslo:
06483836190 06483925190
06483895190 06483933190
...

CONA
Katalogové číslo:
07457057001 07455682001
08063311190

Nastavení oblíbených položek

Produkty, které odebíráte na vašem pracovišti, si můžete označit jako oblíbené. Využijete to pak pro zasílání upozornění na nově vložené dokumenty týkající se těchto produktů.

- Oblíbené položky označíte kdekoliv na stránce vyhledávání nebo produktu **pomocí hvězdičky**, případně v nastavení v sekci **Moje oblíbené**.
- Označit je potřeba jednotlivé produkty (z kategorie **Přístroje** nebo **Reagencie**) a pak také **typy dokumentů**, u kterých vás aktualizace zajímají.

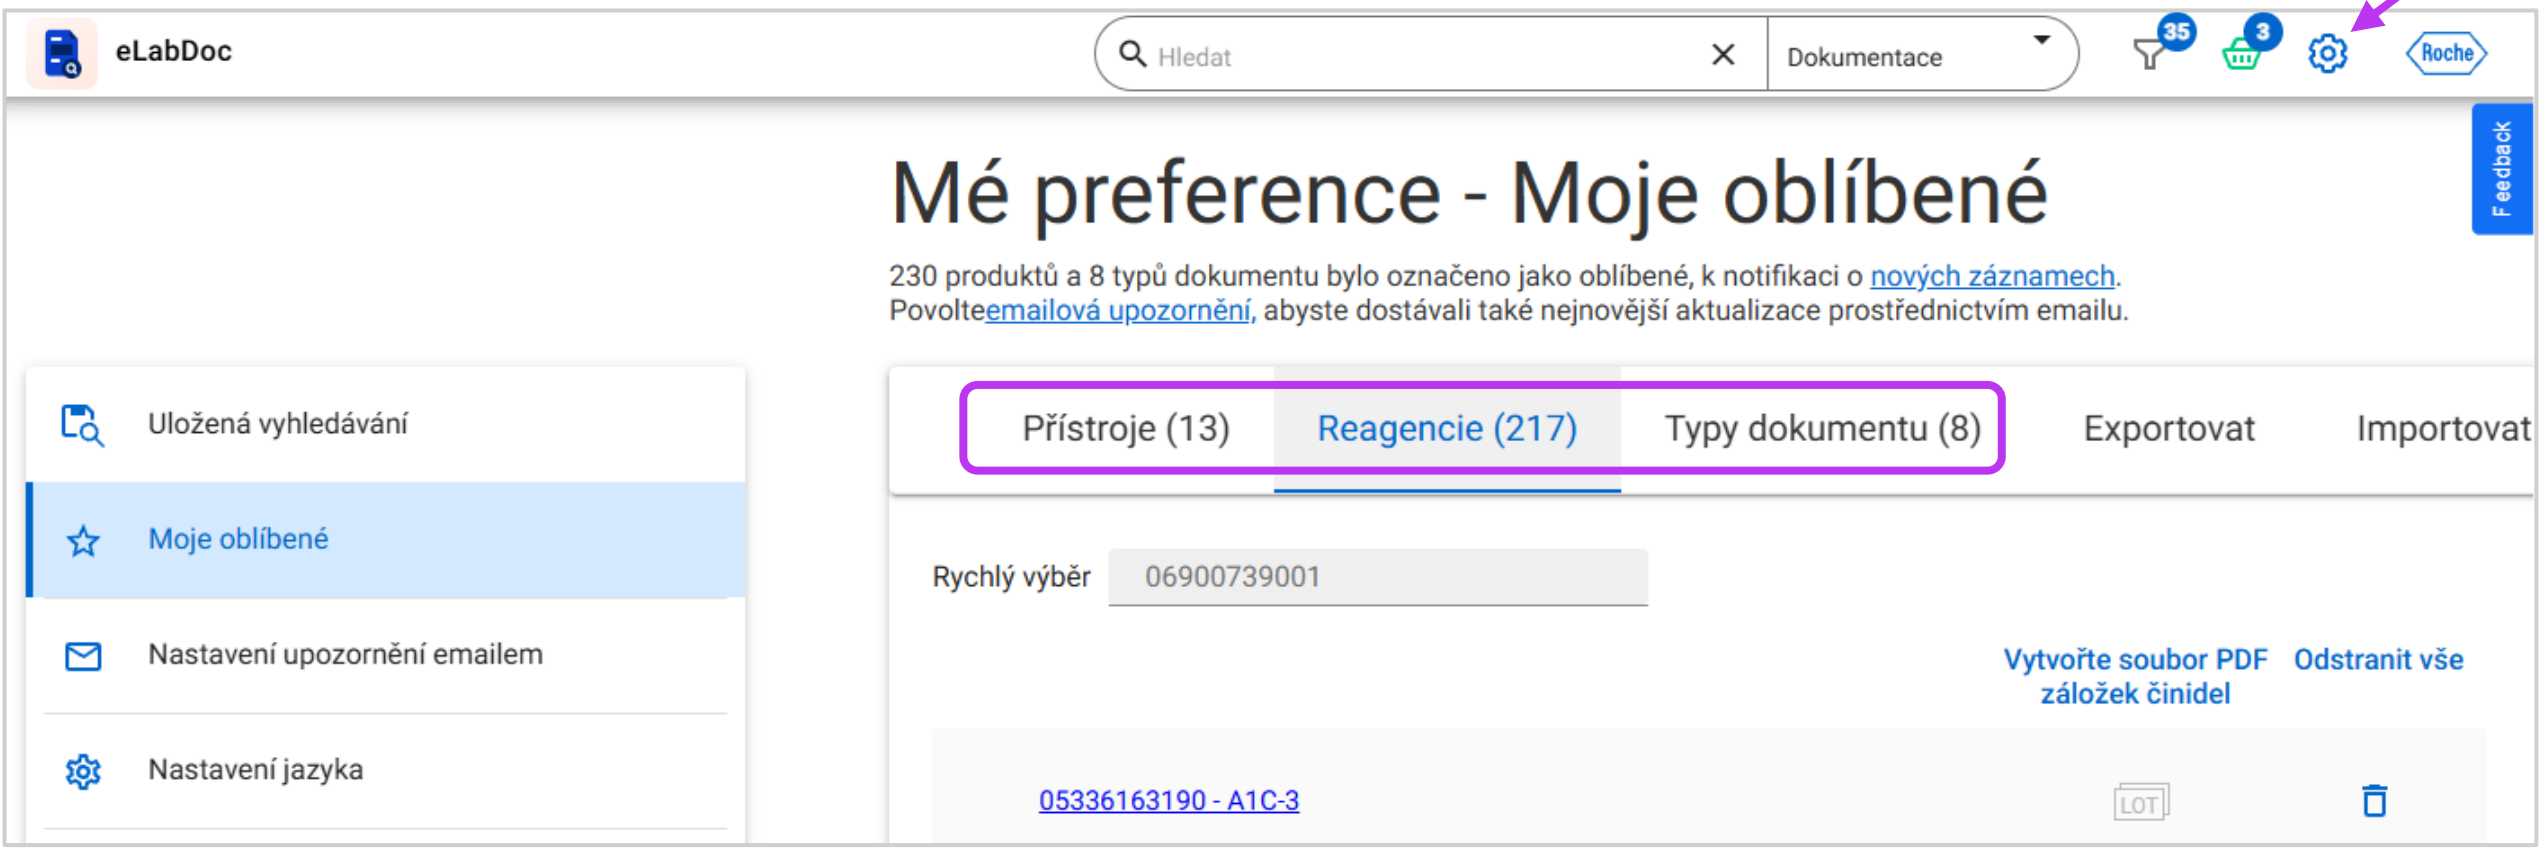

eLabDoc
Hledat
Dokumentace
35
3
Roche
Feedback
Uložená vyhledávání
Moje oblíbené
Nastavení upozornění emailem
Nastavení jazyka
Přístroje (13)
Reagencie (217)
Typy dokumentu (8)
Exportovat
Importovat
Vytvořte soubor PDF záložek činidel
Odstranit vše
LOT

Mé preference - Moje oblíbené

230 produktů a 8 typů dokumentu bylo označeno jako oblíbené, k notifikaci o nových záznamech.
Povolteemailová upozornění, abyste dostávali také nejnovější aktualizace prostřednictvím emailu.

Rychlý výběr: 06900739001

05336163190 - A1C-3

Nastavení upozornění e-mailem

Jakmile si označíte oblíbené produkty a typy dokumentů, můžete v nastavení aktivovat zasílání proaktivních upozornění na nové dokumenty.

1. **Aktivujte** upozornění.
2. **Zvolte frekvenci**, v jaké chcete e-maily s aktualizovanými dokumenty zasílat.
3. Pokud jste do oblíbených produktů dali jak **přístroje, tak reagencie**, pak **upravte logiku upozornění** na hodnotu **A/NEBO**. Pokud máte označeny pouze reagencie, tak ponechte logiku na původní hodnotě **A**.

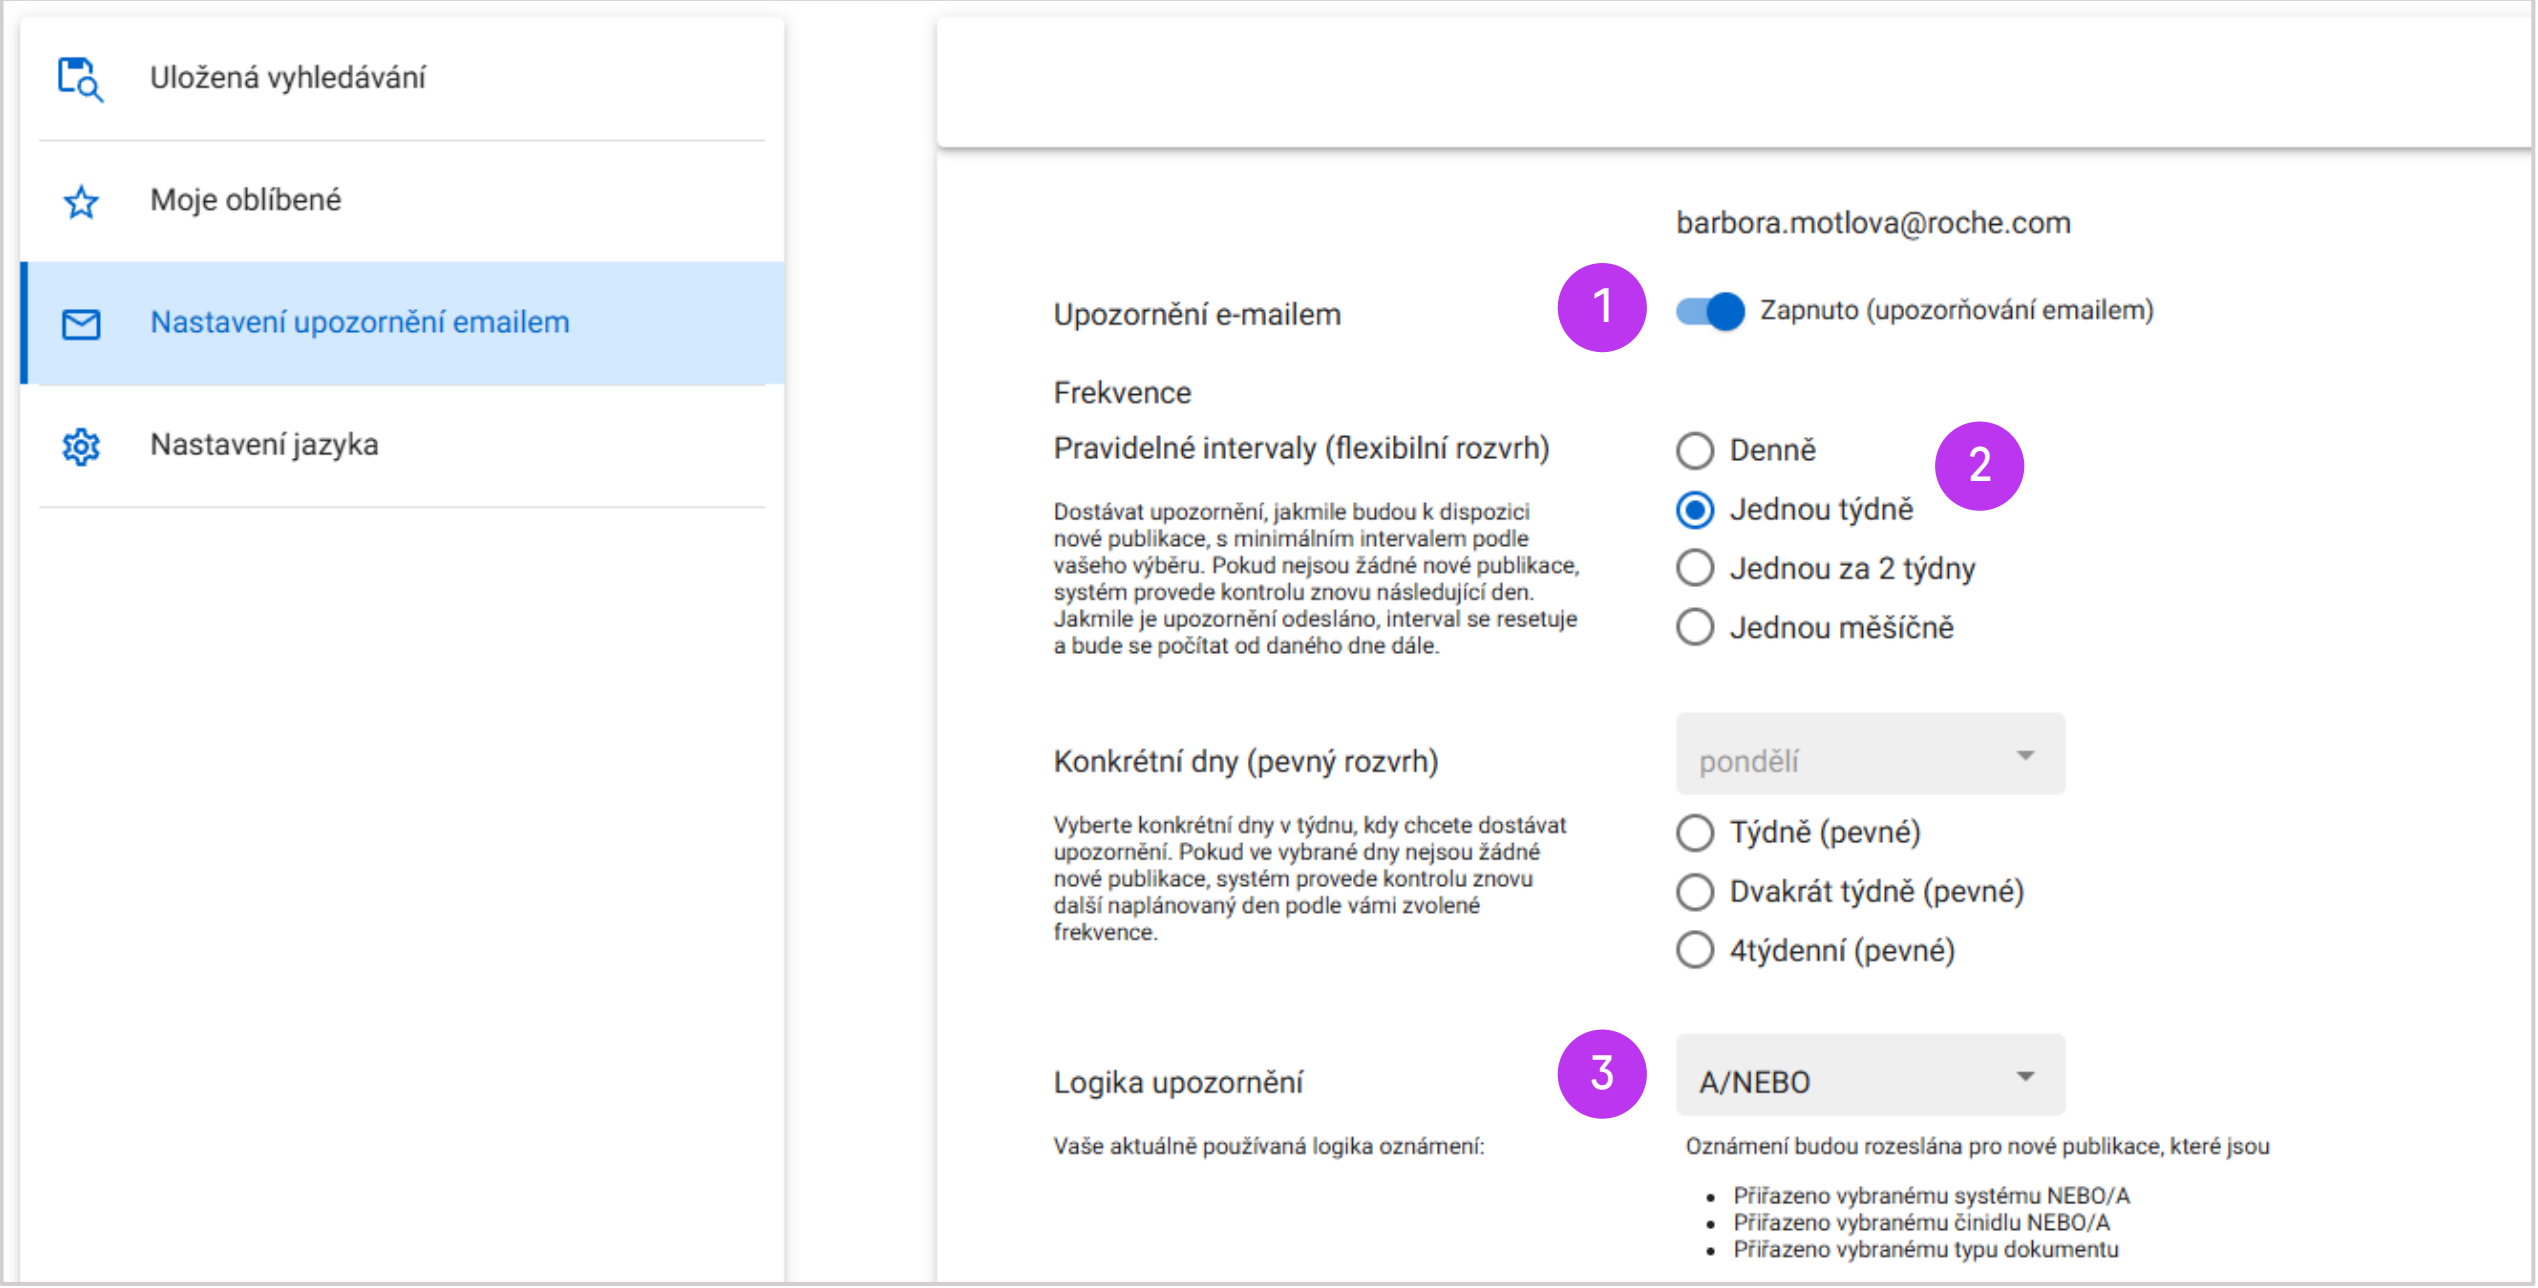

Uložená vyhledávání
Moje oblíbené
Nastavení upozornění emailem
Nastavení jazyka
1
2
3

barbora.motlova@roche.com

Upozornění e-mailem: Zapnuto (upozorňování emailem)

Frekvence

Pravidelné intervaly (flexibilní rozvrh)

Dostávat upozornění, jakmile budou k dispozici nové publikace, s minimálním intervalem podle vašeho výběru. Pokud nejsou žádné nové publikace, systém provede kontrolu znovu následující den. Jakmile je upozornění odesláno, interval se resetuje a bude se počítat od daného dne dále.

○ Denně
● Jednou týdně
○ Jednou za 2 týdny
○ Jednou měšíčně

Konkrétní dny (pevný rozvrh)

Vyberte konkrétní dny v týdnu, kdy chcete dostávat upozornění. Pokud ve vybrané dny nejsou žádné nové publikace, systém provede kontrolu znovu další naplánovaný den podle vámi zvolené frekvence.

pondělí

○ Týdně (pevné)
○ Dvakrát týdně (pevné)
○ 4týdenní (pevné)

Logika upozornění: A/NEBO

Vaše aktuálně používaná logika oznámení:

Oznámení budou rozeslána pro nové publikace, které jsou

- Přiřazeno vybranému systému NEBO/A
- Přiřazeno vybranému činidlu NEBO/A
- Přiřazeno vybranému typu dokumentu

E-mail ze systému bude obsahovat seznam nových dokumentů a odkazy pro jejich otevření.

Sdílení oblíbených položek

Oblíbené produkty můžete sdílet s kolegy ve vaší laboratoři. Pro sdílení máte dvě možnosti:

1. **Exportujte vaše nastavení** oblíbených produktů a dokumentů – tuto možnost můžete využít pouze v případě, že má kolega aktivní registraci na Portál.

V sekci **Moje oblíbené** klikněte na záložku **Exportovat** a zadejte e-mail kolegy, s kterým chcete oblíbené sdílet. Pak klikněte na **Přidat e-mailovou adresu** a **Exportovat oblíbené**.

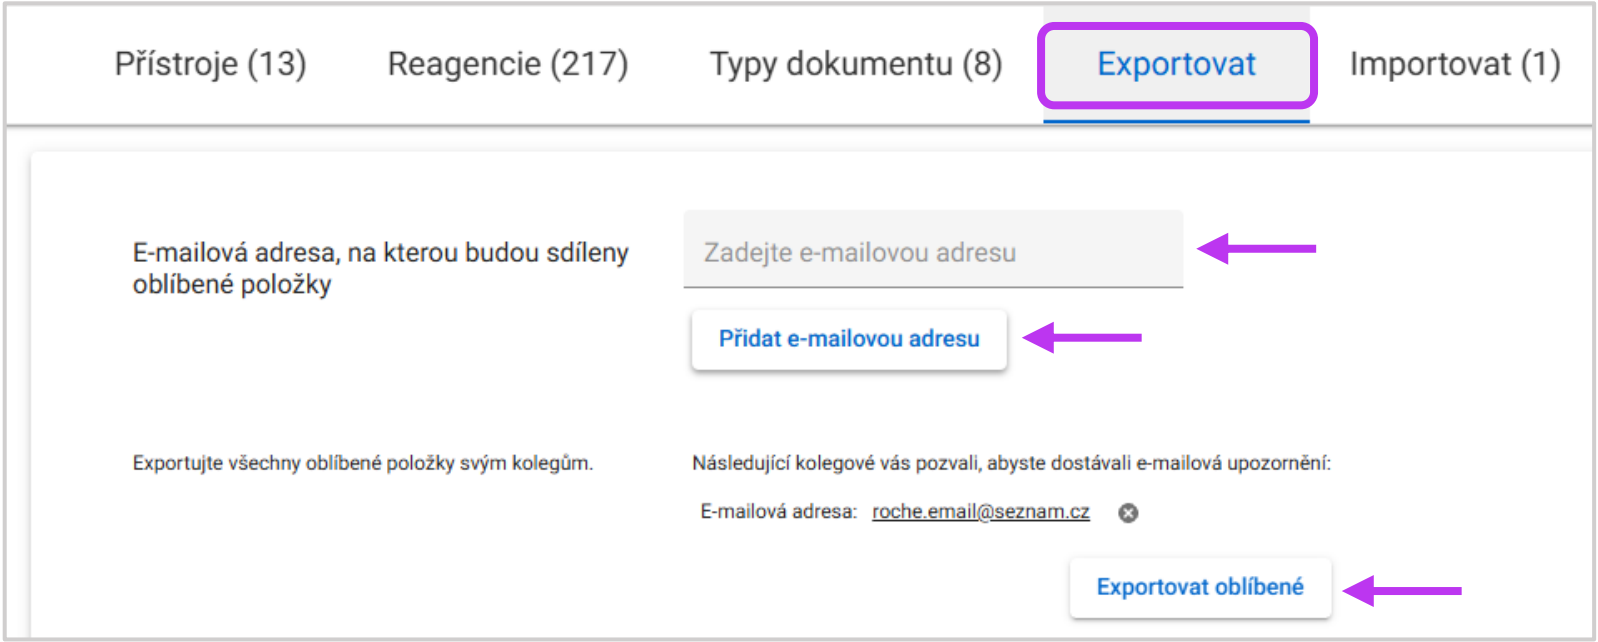
Přístroje (13)
Reagencie (217)
Typy dokumentu (8)
Exportovat
Importovat (1)
Zadejte e-mailovou adresu
Přidat e-mailovou adresu
Exportovat oblíbené

E-mailová adresa, na kterou budou sdíleny oblíbené položky

Exportujte všechny oblíbené položky svým kolegům.

Následující kolegové vás pozvali, abyste dostávali e-mailová upozornění:

E-mailová adresa: roche.email@seznam.cz

Kolegovi se oznámení o sdílení oblíbených položek zobrazí v sekci **Importovat**. Má možnost zde seznam upravit a poté ho importovat kliknutím na **Importovat**.

Pro zasílání upozornění si musí kolega nastavit vlastní proaktivní oznámení v nastavení.

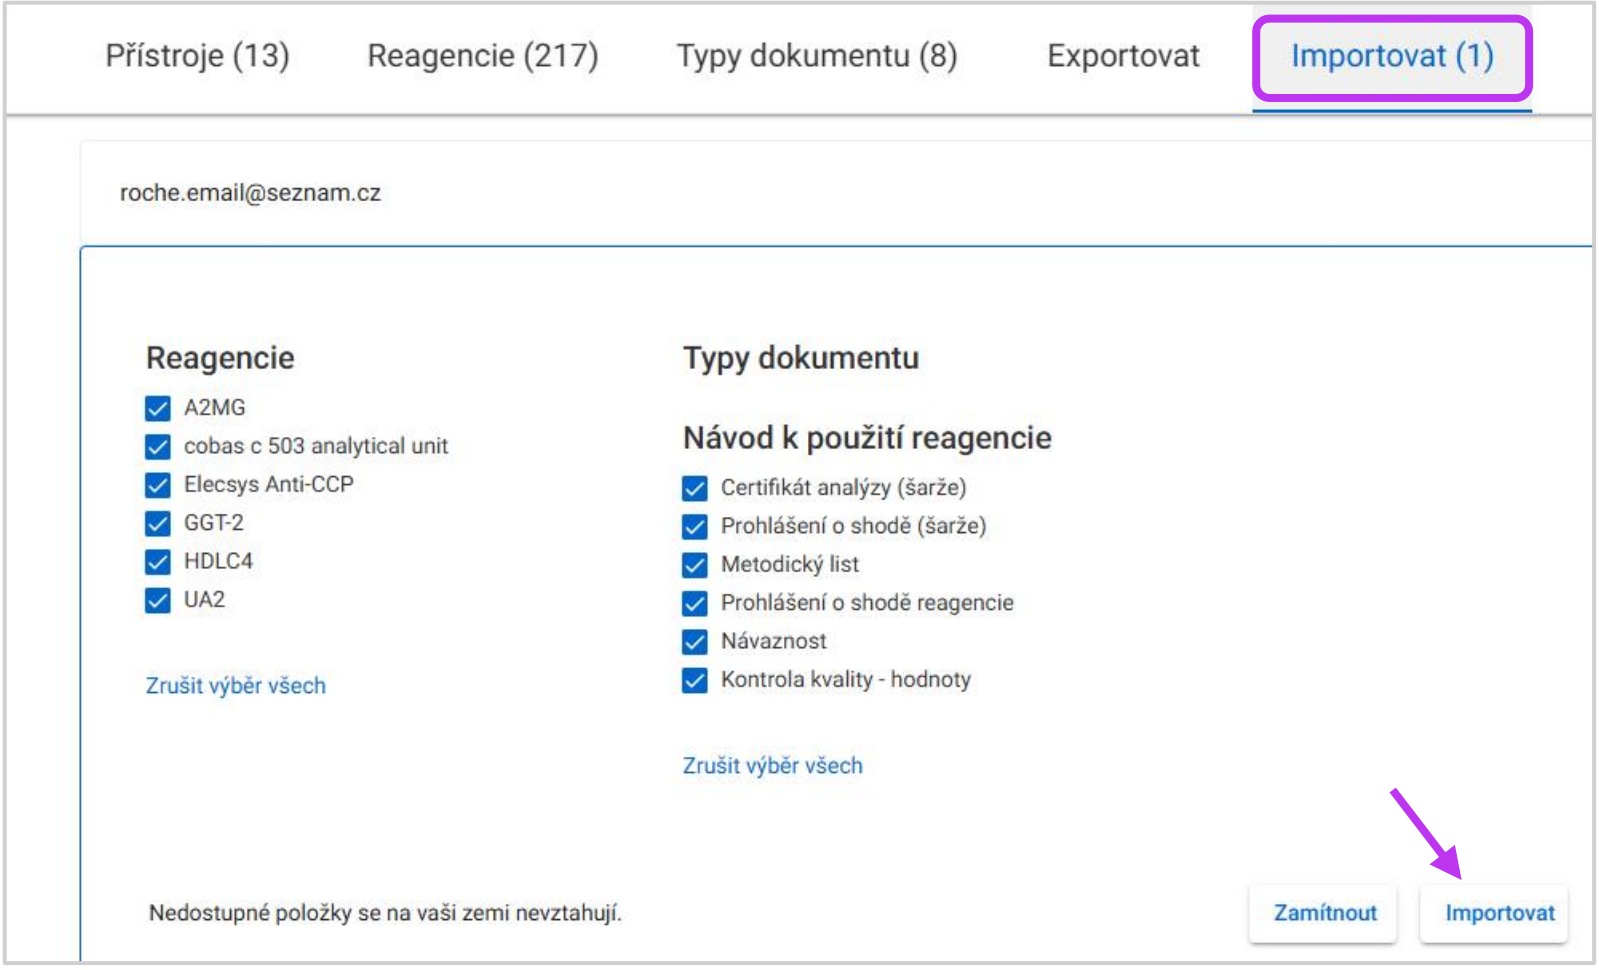
Přístroje (13)
Reagencie (217)
Typy dokumentu (8)
Exportovat
Importovat (1)
Zrušit výběr všech
Zrušit výběr všech
Zamítnout
Importovat

roche.email@seznam.cz

Reagencie

- ☑ A2MG
- ☑ cobas c 503 analytical unit
- ☑ Elecsys Anti-CCP
- ☑ GGT-2
- ☑ HDLC4
- ☑ UA2

Typy dokumentu

Návod k použití reagencie

- ☑ Certifikát analýzy (šarže)
- ☑ Prohlášení o shodě (šarže)
- ☑ Metodický list
- ☑ Prohlášení o shodě reagencie
- ☑ Návaznost
- ☑ Kontrola kvality - hodnoty

Nedostupné položky se na vaši zemi nevztahují.

2. **Sdílejte e-mail s proaktivním upozorněním** – pro využití této možnosti nemusí být kolega zaregistrován na Portálu. V **Nastavení upozornění e-mailem** zadejte e-mail, na který budou chodit stejná upozornění jako vám.

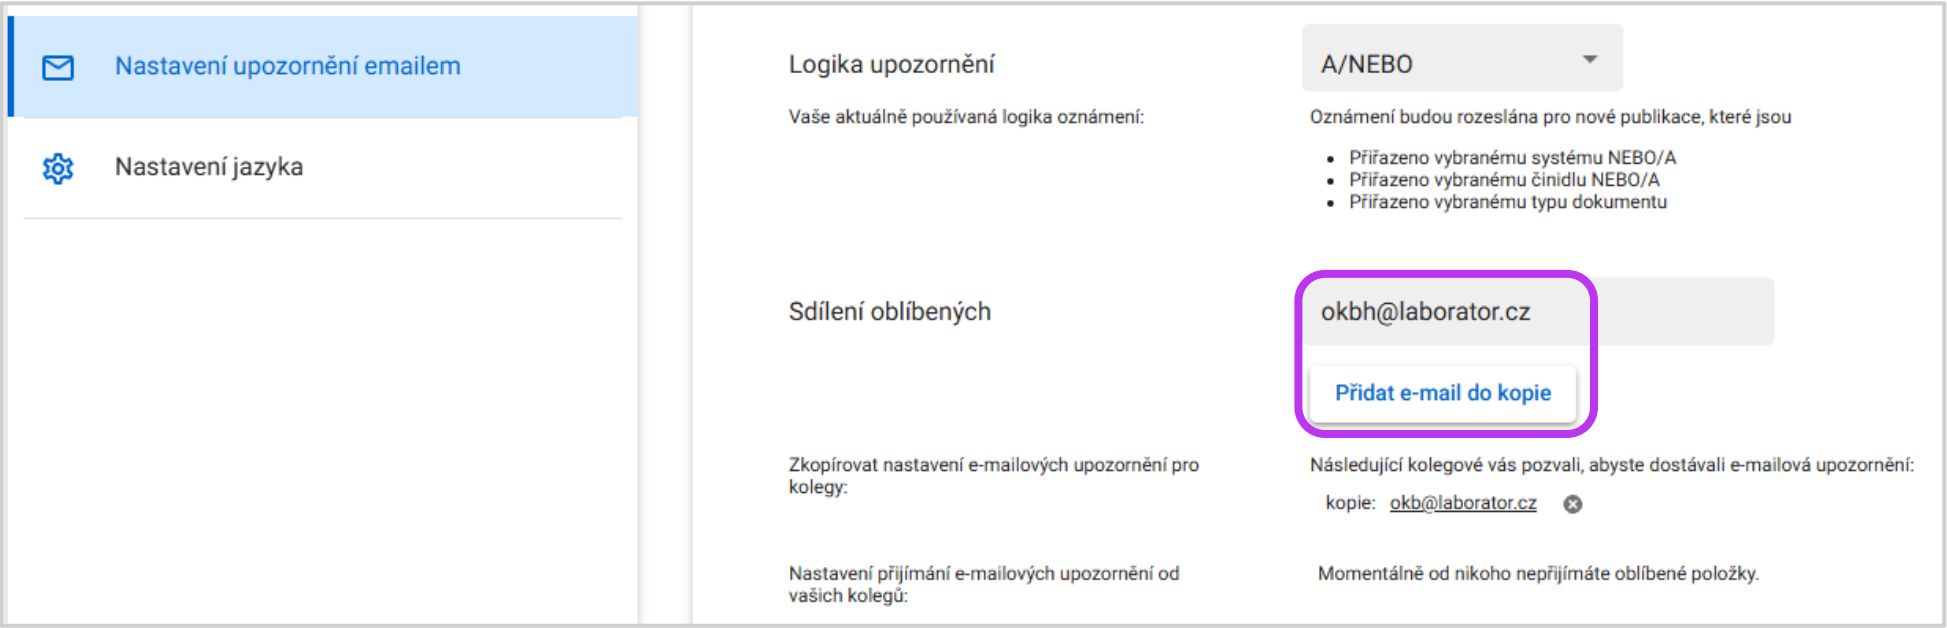
Nastavení upozornění emailem
Nastavení jazyka
Přidat e-mail do kopie

Logika upozornění: A/NEBO

Vaše aktuálně používaná logika oznámení: Oznámení budou rozeslána pro nové publikace, které jsou

- Přiřazeno vybranému systému NEBO/A
- Přiřazeno vybranému činidlu NEBO/A
- Přiřazeno vybranému typu dokumentu

Sdílení oblíbených: okbh@laborator.cz

Zkopírovat nastavení e-mailových upozornění pro kolegy: Následující kolegové vás pozvali, abyste dostávali e-mailová upozornění:

kopie: okb@laborator.cz

Nastavení přijímání e-mailových upozornění od vašich kolegů: Momentálně od nikoho nepřijímáte oblíbené položky.

navify je obchodní značkou společnosti Roche.
© 2026

ROCHE s.r.o.
Sokolovská 685/136F
180 00 Praha

Nemáte přístup na Roche zákaznický Portál **navify**®?
Zaregistrujte se jednoduše na stránce: navifyportal.roche.com